ACCU-CHEK® Combo

Roche

Guida rapida
Accu-Chek® Spirit Combo

Version 2016

ACCU-CHEK®

Indice

Schema del menu del microinfusore	3
Struttura e accessori del microinfusore	4
Funzioni dei tasti	5
Riempimento della cartuccia	6
Inserimento/sostituzione della batteria	8
Impostazione di ora e data	9
Procedura per la programmazione del profilo basale	10
Cambio della cartuccia	12
Riempimento del set d'infusione	16
Avvio e arresto dell'erogazione di insulina	17
Programmazione di un bolo rapido	18
Programmazione di un profilo basale temporaneo (PBT)	20
Annullamento di un profilo basale temporaneo	21
Avvisi	22
Errori	23
Connessione del microinfusore al misuratore	25
Impostazioni in caso di sostituzione del microinfusore	27

Schema del menu del microinfusore

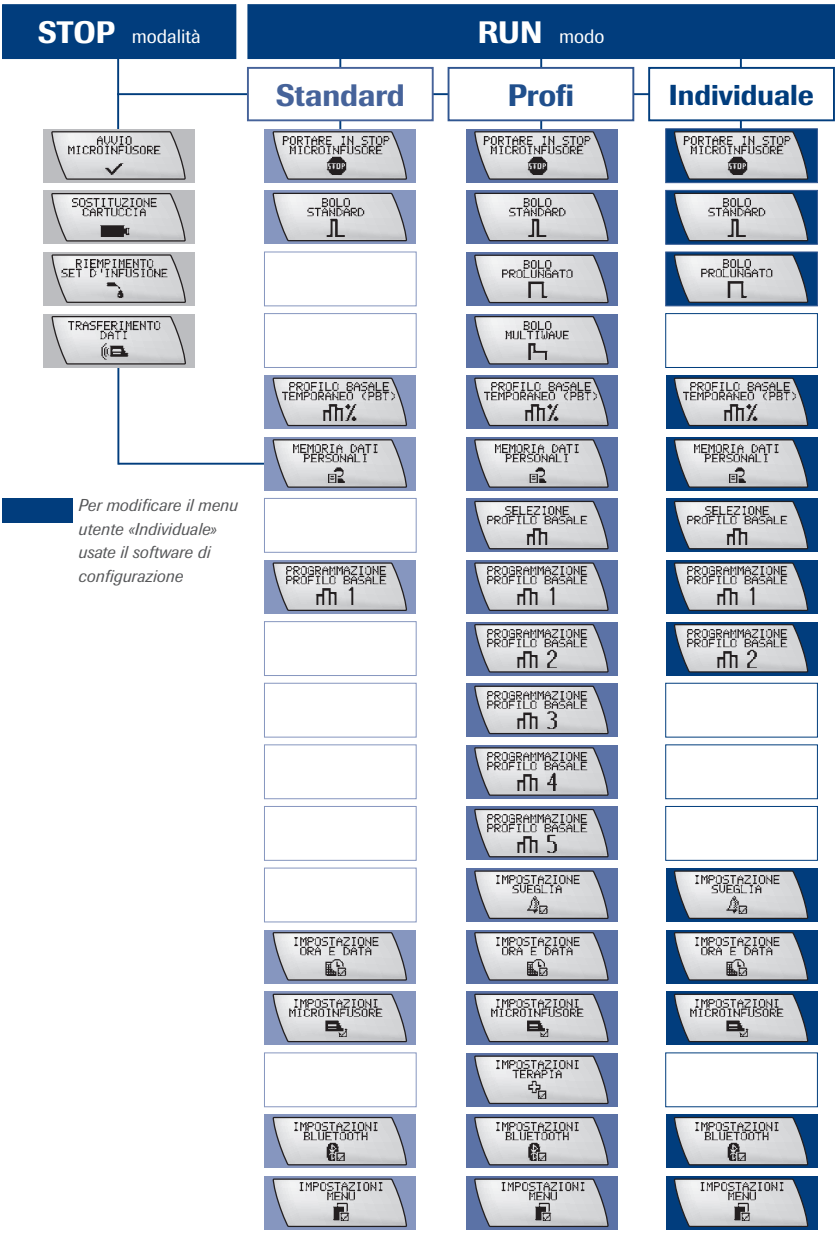

Per modificare il menu utente «Individuale» usate il software di configurazione

Struttura e accessori del microinfusore

Coperchio del vano batteria

Batteria

Chiavetta del vano batteria

Finestra a infrarossi (a lato del coperchio del vano batteria)

Adattatore

Scomparto della cartuccia



Asta del pistone

Piastra terminale

Cartuccia

Stantuffo della cartuccia

Funzioni dei tasti

Tasto	Nome	Funzione
	MENU	▪ Per spostarsi tra menu, schermate di funzioni e informazioni
	OK	▪ Per selezionare un menu ▪ Per salvare le modifiche apportate e uscire dalle schermate di funzioni e informazioni ▪ Per visualizzare la schermata QUICK INFO (che mostra gli ultimi 30 boli somministrati)
	Tasto SU	▪ Per spostarsi in avanti di una schermata di informazioni ▪ Per aumentare un'impostazione ▪ Per accendere la retroilluminazione ▪ Per chiudere l'avviso di STOP (tenere premuto il tasto per 3 sec. fino a quando si sente una musichetta)
	Tasto GIÙ	▪ Per tornare indietro di una schermata di informazioni ▪ Per diminuire un'impostazione ▪ Per chiudere l'avviso di STOP (tenere premuto il

Combinazione	Funzione
	▪ Per uscire da menu, schermate di funzioni e di informazioni senza salvare le modifiche apportate. ▪ Per tornare al menu precedente
	▪ Per sbloccare i tasti (tenere (...) la schermata cambia premuti i pulsanti fino a quando la schermata cambia).
	▪ Per copiare un profilo basale orario nell'ora successiva (durante la programmazione di un profilo basale)

Riempimento della cartuccia

1
Preparare i materiali e lavar si le mani. Per riempire la cartuccia, tirare il pistone del sistema fino in fondo.

2
Appoggiare il flaconcino di insulina su una superficie piana e stabile. Spingere contro il flaconcino il sistema-cartuccia con riempitore, fino a quando si sente un «clic».

3
Spingere il pistone di aspirazione fino in fondo e tenerlo in questa posizione, per produrre una pressione nel flaconcino.

4
Capovolgere il flaconcino con il sistema-cartuccia senza lasciare il pistone di aspirazione. Aspirare l'insulina dal flaconcino, tirando lentamente e regolarmente verso il basso il pistone di aspirazione.

5

Picchiettare la cartuccia con un dito o con una penna per raggruppare al centro eventuali bollicine d'aria formatesi, ed espellerle di nuovo nel flaconcino spingendo il pistone.

6

Con cautela, tirare completamente verso il basso il pistone di aspirazione. Ruotarlo poi in senso antiorario (verso sinistra), staccandolo dalla cartuccia. Staccare il flaconcino dal riempitore.

7

Ruotare il riempitore blu in senso antiorario, staccandolo dalla cartuccia.

8

Coprire l'estremità della cartuccia, innestando il cappuccio di protezione. Eliminare il pistone di aspirazione e il riempitore (componenti blu) nei rifiuti domestici.

Inserimento/sostituzione della batteria

Togliere il coperchio del vano batteria, utilizzando la chiavetta per girare il coperchio in senso antiorario.

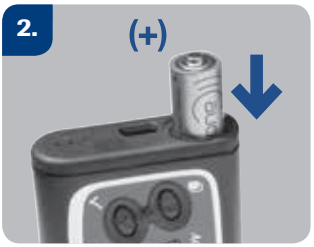

Inserire la batteria nell'apposito vano con il polo negativo (–) verso il basso e il polo positivo (+) verso l'alto.

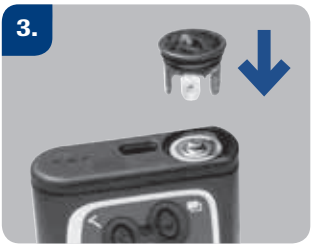

Collocare il coperchio sul polo positivo ed esercitare una leggera pressione sulla batteria, girando il coperchio in senso orario per fissarlo parzialmente.

Utilizzare la chiavetta del vano batteria per fissare completamente il coperchio.

Impostazione di ora e data

1.

Premere ripetutamente il tasto per visualizzare la schermata IMPOSTAZIONE ORA E DATA.

2.



Premere per selezionare. Viene visualizzata la schermata IMPOSTARE ORA. Premere o per impostare l'ora.

3.

Premere per passare alla schermata IMPOSTARE MINUTI. Premere o per impostare i minuti.

4.

Premere per passare alla schermata IMPOSTARE ANNO. Premere o per impostare l'anno.

5.

Usare , e per impostare:

- MESE
- GIORNO
- FORMATO ORA
- FORMATO DATA

6.

Premere per salvare e uscire.

Alla prima accensione del dispositivo si accede direttamente al menu IMPOSTAZIONE DI ORA E DATA

Procedura per la programmazione del profilo basale

Assicurarsi che il microinfusore si trovi in modalità STOP e che il set d'infusione **NON** sia collegato al corpo.

1.

Premere ripetutamente il tasto ◐ per visualizzare la schermata PROGRAMMAZIONE PROFILO BASALE 1 (o 2, 3, 4, 5).

2.

Premere ✓ per selezionare. Viene visualizzato il TOTALE BASALE giornaliero.

3.

Premere ◐ per passare all'impostazione della prima ora. Questa è sempre l'ora successiva alla mezzanotte, che va dalle 00:00 alle 01:00.

4.



Premere ▲ o ▼ per impostare il profilo basale indicato dal medico o dal team diabetologico per l'ora selezionata.

5.



Premere ⧉ per passare all'ora successiva.

6.

Continuare usando i tasti ⧉, ▲ e ▼ per impostare i profili basali orari per le ore restanti. Questo consente di programmare il proprio profilo basale personale su una base oraria. Proseguire fino a programmare tutte le 24 ore.

7.

Premere ✓ per confermare.
Viene visualizzato il nuovo TOTALE BASALE giornaliero.
Premere ✓ per salvare il profilo e uscire.

Gli incrementi del profilo basale orario dipendono dall'ultimo valore impostato: saranno di
0,01 U/h da 0,05 U/h a 1,00 U/h,
0,05 U/h da 1,00 U/h a 10,0 U/h e
0,1 U/h da 10,0 U/h a 50,0 U/h.

Cambio della cartuccia

Rimuovere il tappo protettivo dalla cartuccia.
NON toccare la punta della cartuccia.

Spingere completamente l'adattatore nella punta della cartuccia, fino all'arresto.

Preparare con cura un nuovo set d'infusione Accu-Chek seguendo le istruzioni per l'uso fornite.

Tenere l'adattatore e ravvitare in senso orario l'attacco Luer del set d'infusione all'adattatore. Non serrare eccessivamente.

Se necessario, rimuovere la cartuccia. Svitare la cartuccia con cautela e tirarla fuori solo dopo che è completamente svitata.

Premere il tasto menu per passare alla schermata SOSTITUZIONE CARTUCCIA. Premere il tasto OK per selezionare.

Assicurarsi che il set d'infusione sia scollegato e che la cartuccia sia stata rimossa. Tenere premuto il tasto OK per 3 secondi fino a quando si sente una musichetta.

L'asta del pistone inizia a rientrare. Non toccare o disturbare in alcun modo l'asta del pistone durante il movimento, per evitare di danneggiare il microinfusore.

Dopo il rientro completo dell'asta del pistone, la schermata Q.TA CARTUCCIA mostra il volume massimo (315 U).

Tenere il microinfusore in verticale. Tenere la nuova cartuccia riempita in modo che l'adattatore connesso e il set d'infusione puntino verso l'alto e siano paralleli e vicini allo scomparto della cartuccia.

Accertarsi che il bordo superiore della parte filettata dell'adattatore si trovi in corrispondenza della parte superiore dello scomparto della cartuccia.

Premere ▲ o ▼ per muovere l'asta del pistone in modo che la piastra terminale dell'asta del pistone sia allineata con il fondo dello stantuffo della cartuccia.

Posizionare il microinfusore diagonalmente verso il basso (con l'adattatore diretto verso il basso). Inserire la cartuccia nello scomparto della cartuccia.

Ruotare (non spingere o premere) l'adattatore in senso orario fino a che raggiunge la sede corretta nello scomparto della cartuccia.

La cartuccia è inserita correttamente se la piastra terminale dell'asta del pistone poggia correttamente contro lo stantuffo della cartuccia.

16

Se la piastra terminale dell'asta del pistone non è allineata correttamente con lo stantuffo della cartuccia, rimuovere la cartuccia dallo scomparto e ripetere i passi 10–14.

17

Controllare che l'attacco Luer del set d'infusione sia ancora collegato correttamente all'adattatore. Serrare manualmente in senso orario il set d'infusione fino a farlo poggiare saldamente nell'adattatore.

18

Premere OK dopo aver inserito correttamente la cartuccia. Il microinfusore esegue un'autoverifica.

19

Al termine dell'autoverifica compare la schermata RIEMPIMENTO SET D'INFUSIONE. Riempire il set d'infusione significa riempire di insulina il set d'infusione ed espellere eventuali bolle d'aria. Continuare il processo come descritto nelle istruzioni per l'uso.

NON inserire la cartuccia nel microinfusore prima di aver collegato la cannula del set d'infusione alla cartuccia. Questo potrebbe causare l'afflusso di insulina nello scomparto della cartuccia.
Se l'insulina rimane nello scomparto, nel tempo può danneggiare l'asta del pistone, ed eventualmente compromettere il funzionamento del motore del microinfusore.

NON tenere il microinfusore in verticale durante l'inserimento della cartuccia. Questo potrebbe causare l'afflusso di insulina nello scomparto della cartuccia e il blocco del pistone. Di conseguenza, il microinfusore visualizzerebbe un messaggio d'errore E6 o E10 o si arresterebbe.

Un uso scorretto del microinfusore può danneggiarlo.

Riempimento del set d'infusione

Assicurarsi che il microinfusore si trovi in modalità STOP e che il set d'infusione **NON** sia collegato al corpo.

1.

Premere ripetutamente il tasto ◉ per visualizzare la schermata RIEMPIMENTO SET D'INFUSIONE. Premere ✓ per selezionare. Sul display viene visualizzata la quantità di riempimento (25 unità).

2.

Tenere premuto ✓ per tre secondi, fino a quando si sente una musichetta. Il processo di riempimento inizia.

3.

Per assicurarsi che tutte le bolle d'aria siano eliminate, tenere sempre il microinfusore in verticale. Dopo che l'insulina è entrata nella cannula, picchiettare delicatamente il fondo del microinfusore con il palmo della mano.

4.

Durante la procedura di riempimento, sul display viene visualizzato il conteggio incrementale della quantità di insulina utilizzata per il riempimento. Il microinfusore interrompe automaticamente il riempimento dopo aver erogato 25 unità. È possibile arrestare in anticipo il processo di riempimento premendo ✓.

Avvio e arresto dell’erogazione di insulina

Quando il microinfusore non eroga insulina, si trova in modalità **STOP**.
Quando eroga insulina, si trova in modalità **RUN**.

Avvio dell’erogazione di insulina

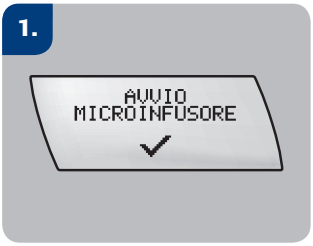

In modalità STOP, premere ⓘ per passare alla schermata AVVIO MICROINFUSORE.

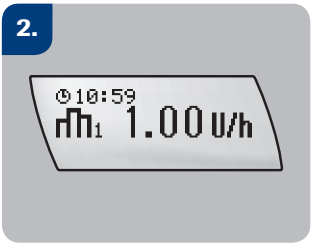

Premere ✓. Il microinfusore passa alla modalità RUN e inizia a erogare insulina. Assicurarsi che l’ora e la data del microinfusore siano impostate correttamente.

Arresto dell’erogazione di insulina

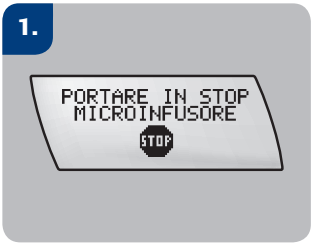

In modalità RUN, premere ⓘ per passare alla schermata PORTARE IN STOP MICROINFUSORE.

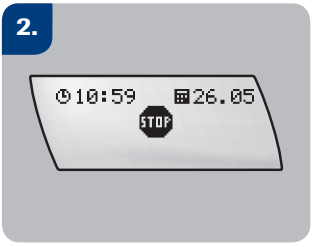

Premere ✓. Il microinfusore passa alla modalità STOP e interrompe l’erogazione di insulina.

Programmazione di un bolo rapido

Per una programmazione discreta e comoda del bolo senza il misuratore, è possibile utilizzare la funzione Bolo rapido del microinfusore.

1.

Dalla schermata RUN, premere e tenere premuto ▼ fino a udire una sequenza di segnali acustici e a sentire una vibrazione. Questo attiva la funzione Bolo rapido.

2.



Premere ▲ una volta per ogni incremento fino a raggiungere la quantità di bolo richiesta.

3.

Ogni volta che si preme il tasto, il microinfusore emette un segnale acustico e vibra una volta per ogni incremento del bolo programmato.

4.

Cinque secondi dopo l'ultimo azionamento di ▼, il microinfusore conferma la quantità totale del bolo con un segnale acustico e una vibrazione per ogni incremento del bolo programmato.

5.

Il simbolo del bolo standard lampeggia per 5 secondi (ritardo di avvio nell'erogazione del bolo).

6.

Dopo il ritardo di avvio nell'erogazione del bolo, il microinfusore emette tre segnali acustici e quindi inizia a erogare la quantità totale del bolo programmata. Sul display viene visualizzato un conto alla rovescia della quantità di bolo restante.

Come impostazione predefinita, l'incremento per il bolo rapido è di 0,5 U (ciò significa che a ogni pressione del tasto la quantità di bolo programmata aumenta di 0,5 unità). Se necessario, chieda al suo medico o al suo team diabetologico di modificare l'incremento a 0,1, 0,2, 1,0 o 2,0 U. (vedi pag. 27).

Annullamento di un bolo rapido

Durante la programmazione del Bolo rapido:	Premere il tasto ⏷ o (⏷) usato per attivare la funzione Bolo rapido. In questo modo, si ripristina la quantità di bolo impostata a 0,0 unità; il microinfusore emette una musichetta di conferma. Se non viene programmato alcun bolo nuovo, dopo cinque secondi il microinfusore torna alla schermata RUN ed emette tre segnali acustici.	NON viene erogato alcun bolo
Durante la conferma o il ritardo di avvio:	Premere ⏶ o ⏷. Si sente una musichetta e il microinfusore torna alla schermata RUN. Si attiva l'avviso W8: BOLO ANNULLATO. Premere due volte ✓ per confermare e disattivare l'avviso.	NON viene erogato alcun bolo
Durante l'erogazione del bolo:	Tenere premuto ⏶ o ⏷ fino a quando si sente una musichetta (circa tre secondi). Si attiva l'avviso W8: BOLO ANNULLATO. Premere due volte ✓ per confermare e disattivare l'avviso.	L'erogazione del bolo viene interrotta

Programmazione di un profilo basale temporaneo (PBT)

1.

Dalla schermata RUN, premere ripetutamente il tasto ⓘ per visualizzare la schermata PROFILO BASALE TEMPORANEO (PBT).

2.

Premere ✓ per selezionare. Viene visualizzata la schermata PERCENTUALE PBT.

3.

Utilizzare i tasti ▲ (aumentare) o ▼ (diminuire) per selezionare la percentuale PBT desiderata. Premere ⓘ per passare alla schermata DURATA PBT.

4.

Premere ▲ o ▼ per impostare la durata. Premere ✓ per salvare e uscire.

Al termine del PBT si attiva l'avviso W7: PBT FINITO.
Premere due volte ✓ per confermare e disattivare l'avviso.

Annullamento di un profilo basale temporaneo

Metodo 1:

- Premere ripetutamente per visualizzare la schermata PROFILO BASALE TEMPORANEO (PBT).
- Premere per selezionare. Premere o per impostare la percentuale al 100 %.
- Premere per confermare.
- Si attiva l'avviso W6: PBT ANNULLATO. Premere due volte per confermare e disattivare l'avviso. Il microinfusore torna alla schermata RUN.

Metodo 2:

- Premere ripetutamente per visualizzare la schermata PORTARE IN STOP MICROINFUSORE.
- Premere per confermare.
- Si attiva l'avviso W6: PBT ANNULLATO. Premere due volte per confermare e disattivare l'avviso. Il microinfusore passa alla modalità STOP.
- Premere ripetutamente per visualizzare la schermata AVVIO MICROINFUSORE.
- Premere per confermare. Il microinfusore passa nuovamente alla modalità RUN.

Avvisi

Per favore consulti anche le istruzioni dettagliate presenti nel manuale utente.

Per confermare un avviso: premere 2 volte il tasto conferma ✓

CART IN ESAURIM
⚠ W 1
✓ PER CONFERMARE

Cartuccia in esaurimento
La cartuccia contiene ancora 20 unità di insulina.
▶ Sostituire la cartuccia prima che sia completamente vuota

BATT IN ESAURIM
⚠ W 2
✓ PER CONFERMARE

Batteria in esaurimento
▶ Sostituire la batteria il più presto possibile

VERIFICA DATAORA
⚠ W 3
✓ PER CONFERMARE

Verificare data e ora
L'alimentazione del microinfusore è stata interrotta per più di un'ora. Le altre impostazioni del microinfusore e i dati in memoria si conservano anche in caso di interruzione dell'alimentazione
▶ Controllare ora e data e correggerle, se necessario.

CHIAMARE N.VERDE
⚠ W 4
✓ PER CONFERMARE

Chiamare Numero Verde
Questo avviso viene visualizzato dopo sei anni di utilizzo del microinfusore.
▶ Eventualmente, la data e l'ora devono essere reimpostate

AVVISO FINE FUNZ
⚠ W 5
✓ PER CONFERMARE

Avviso fine funzionamento (vale solo per il microinfusore di ricambio di emergenza
Il periodo di funzionamento del microinfusore di emergenza sta per scadere, rimangono ancora 30 giorni di funzionamento. Questo avviso viene visualizzato solo per il microinfusore di emergenza (clienti con un contratto classico). Importante: se si sceglie un contratto classico, ril microinfusore di emergenza deve essere utilizzato solo come riserva in caso di necessità.(Nel menu DATI PERSONALI, è possibile controllare il tempo d'uso restante).

PBT ANNULLATO
⚠ W 6
✓ PER CONFERMARE

PBT annullato
Il profilo basale temporaneo (aumento/diminuzione) è stato annullato (il microinfusore in modalità STOP o è stato impostato un profilo basale al 100%).
▶ Avviare il microinfusore (il profilo basale continua al 100%)
Il PBT è stato annullato volontariamente?
▶ Se l'annullamento è stato involontario, programmare un nuovo profilo basale temporaneo (se necessario)

PBT TERMINATO
⚠ W 7
✓ PER CONFERMARE

PBT terminato
L'avviso informa che il profilo basale temporaneo programmato è terminato. Quando compare l'avviso, l'erogazione procede automaticamente con il profilo basale originale (100%)
▶ Valutare se è necessaria un'ulteriore modifica del profilo basale temporaneo
▶ Se è necessaria, programmare un nuovo profilo basale temporaneo

* L'avviso W7 può essere disattiva to tramite il software di configurazione Accu-Chek.

BOLO ANNULLATO
⚠ W 8
✓ PER CONFERMARE

Bolo annullato
▶ Verificare se la cancellazione è stata volontaria e, se necessario, programmare un nuovo bolo
▶ La quantità di bolo effettivamente erogata prima dell'interruzione può essere consultata nella schermata QUICK INFO
▶ premere 2 volte il tasto conferma ✓

Errori

Il microinfusore di insulina passa automaticamente in modalità STOP

Per favore consulti anche le istruzioni dettagliate presenti nel manuale utente.

Per confermare un errore: premere 2 volte il tasto conferma ✓

CARTUCCIA VUOTA
E1
✓ PER CONFERMARE

Cartuccia vuota

▶ Sostituire subito la cartuccia

BATTERIA SCARICA
E2
✓ PER CONFERMARE

Batteria scarica

▶ Sostituire subito la batteria

AUTOSPEGNIMENTO
E3
✓ PER CONFERMARE

Autospegnimento

L'autospegnimento è una funzione di sicurezza che interrompe l'erogazione di insulina e visualizza l'errore E3 quando non viene premuto alcun tasto per un determinato periodo di tempo in modalità RUN. Questa funzione può essere attivata o disattivata dal menu IMPOSTAZIONI TERAPIA.

OCCLUSIONE
E4
✓ PER CONFERMARE

Occlusione

Se appare sul display il messaggio di errore E4: OCCLUSIONE, controllare la glicemia immediatamente e di nuovo dopo, 2 ore, in quanto l'erogazione d'insulina è stata interrotta. Se i valori della glicemia sono elevati, prendere subito le misure appropriate in base alle istruzioni del medico o del team diabetologico. Questa situazione può essere causata da: un set d'infusione bloccato, un catetere piegato, raramente una cartuccia danneggiata, un pistone sporco o danneggiato.

▶ Sostituire l'intero set d'infusione (compresa la cannula) e riempirlo
▶ Ricollegare il set d'infusione al sito d'infusione
▶ Avviare il microinfusore

FINE TIMER MICRO
E5
✓ PER CONFERMARE

Fine Timer micro (vale solo per il microinfusore di riserva /di emergenza)

Il periodo di funzionamento del microinfusore di emergenza è terminato. Il microinfusore va in modalità STOP e smette di funzionare. Se si usa il microinfusore correttamente, questo errore non si verifica, visto che il microinfusore di riserva deve essere usato solamente per il tempo necessario a ottenere un nuovo microinfusore.

ERR MECCANICA
E6
✓ PER CONFERMARE

Errore meccanico

▶ Scollegare o rimuovere il set d'infusione dal sito d'infusione
▶ Rrimuovere dal microinfusore la cartuccia, l'adattatore, il set d'infusione
▶ Rimuovere la batteria e inserire una nuova batteria
▶ Inserire una cartuccia e un set d'infusione nuovi, riempire il set d'infusione e ricollegare il set d'infusione al sito d'infusione, avviare il microinfusore
▶ Se sul display appare nuovamente l'errore E6 ERRORE MECCANICO, contattare il Numero verde 0800 11 00 11

ERR ELETTRONICA
E7
REINSERIRE BATT

Errore elettronico

▶ Scollegare o rimuovere il set d'infusione dal sito d'infusione
▶ Cambiare la batteria
▶ Riempire il set d'infusione fino a far gocciolare l'insulina dall'estremità della cannula
▶ Ricollegare il set d'infusione al sito d'infusione e avviare il microinfusore

Dopo un errore E7, controllare sempre le impostazioni personali (profilo basale, data/ora)

▶ Se sul display appare nuovamente l'errore E7: contattare il Numero verde 0800 11 00 11

Alimentazione interrotta

L'errore E8 si verifica quando si inserisce una nuova batteria senza aver prima portato il microinfusore in modalità STOP, in caso di caduta accidentale del microinfusore o se non si cambia regolarmente il copri batteria

- Cambiare il copribatteria
- Verificare ora e data e correggerle se necessario, avviare il microinfusore.

Se necessario programmare un nuovo bolo e/o un nuovo profilo basale temporaneo. Se l'errore E8 si verifica durante la programmazione, controllare le impostazioni personali.

Errore cartuccia

La funzione «Sostituzione cartuccia» non è stata eseguita correttamente.

- Scollegare o rimuovere il set d'infusione dal sito d'infusione
- Rimuovere la cartuccia
- In modalità STOP, attivare la funzione «Sostituzione cartuccia»
- Reinserire la cartuccia
- Riempire il set d'infusione e ricollegare il set d'infusione al sito d'infusione
- Avviare il microinfusore

Se l'errore E10: ERRORE CARTUCCIA appare mentre si ritrae il pistone:

- Inserire una nuova batteria nel microinfusore e ripetere la procedura

Set vuoto

La cartuccia è stata cambiata, ma il set d'infusione non è stato riempito. Il messaggio d'errore appare quando si cerca di avviare il microinfusore.

- Scollegare o rimuovere il set d'infusione dal sito d'infusione
- Riempire il set d'infusione
- Ricollegare il set d'infusione al sito d'infusione e avviare il microinfusore

Problemi di connessione:

Se non è possibile attivare il simbolo Bluetooth sul misuratore, neanche tramite il menu « Impostazioni/Strumento/Bluetooth»:

1. Rimuovere le batterie, aspettare alcuni minuti e rimetterle in posizione
2. Eventualmente inserire nuove batterie AAA

Consiglio finale:

Se lei effettua un bolo direttamente con il microinfusore o tramite il misuratore (Menu Microinfusore), prima di eseguire la prossima misurazione della glicemia acceda al Menu Memoria «dati personali» per consentire la sincronizzazione fra i dati del microinfusore e del misuratore. Se non si esegue questa operazione, il bolo viene salvato solo nella memoria del microinfusore. Ciò porta a problemi di cronologia nei dati «Andamento».

Connessione del microinfusore al misuratore

Schermata del microinfusore:

IMPOSTAZIONI
BLUETOOTH

Premere ripetutamente il tasto visualizzare la alla schermata IMPOSTAZIONI BLUETOOTH.
Premere per selezionare

CANCELLARE DISP
DM_574328192
✔ PER CANCELLARE

Premere per passare alla schermata CANCELLARE DISP.
Premere una volta per cancellare la connessione e una seconda volta per confermare.

CANCELLARE DISP
DM_574328192
✔ PER CONFERMARE

Premere una seconda volta
per confermare.
▶ Sul display appare la scritta: DISPOSITIVO COLLEGATO NESSUN DISPOSITIVO

BLUETOOTH
ON

Premere per selezionare la schermata BLUETOOTH
Premere o per attivare la funzione Bluetooth®.

AGGIUNGERE DISP
AVVIA CONNESS
✔ PER AVVIARE

Premere il tasto sul microinfusore per visualizzare la schermata AGGIUNGERE DISP e premere per avviare la connessione.

Schermata del misuratore:

Tenere premuto il tasto dell'illuminazione ☼, quindi tenere premuto anche il tasto di accensione ⏻ fino a quando appare la schermata a fianco; quindi rilasciare entrambi i tasti.

Schermata del microinfusore:

AGGIUNGERE DISP
DM_568315224
>>DM_574328192

Selezionare il giusto misuratore utilizzando i tasti SU o GIU' (verificare il numero di serie sul lato posteriore del misuratore), quindi confermare con il tasto conferma ().

AGGIUNGERE DISP
CONNESSIONE

Connessione al dispositivo in corso.
L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

AGGIUNGERE DISP
INSERIRE COD.PIN
771 242 9832
SU MISURATORE

Il microinfusore visualizza un codice PIN a 10 cifre.

Schermata del misuratore

Utilizzando i tasti, ▲ e ▼, inserire nel misuratore il codice visualizzato sul display del microinfusore, quindi premere il tasto centrale per confermare. Una volta inserito il codice completo, premere il tasto funzionale «Conferma».

Schermata del microinfusore:

Premere ✓ per uscire dal menu.

Schermata del misuratore

Spegnere il misuratore. ⓘ

Impostazioni in caso di sostituzione del microinfusore

Display – se nessun tasto viene premuto, dopo 20 secondi lo schermo si spegne.

Scelta della lingua – attraverso il menu Impostazioni Microinfusore (Pump Settings)

Regolazione della data – attraverso il menu Impostazione Ora e Data

Incremento bolo – attraverso il menu Impostazioni Terapia

Quick Info – attraverso il menu della schermo ata RUN

Desidera ulteriori informazioni?

I nostri collaboratori del Centro di assistenza ai clienti Accu-Chek sono a sua disposizione! **Li contatti al numero verde 0800 11 00 11**
Oppure visiti il nostro sito internet: **www.accu-chek.ch/combo**

08.071.837.001 / 09-16 / PDF italiano

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG. Inc. L'qualsiasi utilizzo di detti marchi in associazione a ACCU-CHEK viene effettuato su licenza Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK TENDERLINK, ACCU-CHEK FLEXLINK, ACCU-CHEK RAPID D-LINK sono marchi di Roche. © 2016 Roche. Tutti i diritti riservati.

Experience what's possible.

www.accu-chek.ch

Roche Diabetes Care (Schweiz) AG
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz

ACCU-CHEK®